

TRAITEMENT D'IMAGES

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE ET TOMOGRAPHIE

Max Mignotte

Département d'Informatique et de Recherche Opérationnelle.
[Http : //www.iro.umontreal.ca/~mignotte/ift6150](http://www.iro.umontreal.ca/~mignotte/ift6150)
E-mail : mignotte@iro.umontreal.ca

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE ET TOMOGRAPHIE

SOMMAIRE


Exemples	2
Transformations Géométriques	3
Interpolation Directe	4
Interpolation Bilinéaire	6
Autres Interpolations	8
Tomographie	9

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE EXEMPLES

Exemples de distorsions géométriques




Exemples de corrections géométriques

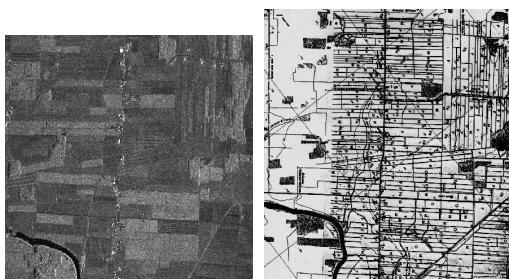


CORRECTION GÉOMÉTRIQUE TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

Translation




$$\begin{aligned}x' &= a + x \\y' &= b + y\end{aligned}$$

Echelle



$$\begin{aligned}x' &= a \cdot x \\y' &= b \cdot y\end{aligned}$$

Inclinaison



$$\begin{aligned}x' &= x + a \cdot y \\y' &= y\end{aligned}$$

Rotation

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta + y \sin \theta \\y' &= -x \sin \theta + y \cos \theta\end{aligned}$$

Assignation des niveaux de gris


► Nécessaire car la position d'un pixel transformé n'est pas entière

- Interpolation au voisin le plus proche
- Interpolation bilinéaire
- Autres type d'interpolation




CORRECTION GÉOMÉTRIQUE INTERPOLATION DIRECTE (1)

Transformée spatiale directe

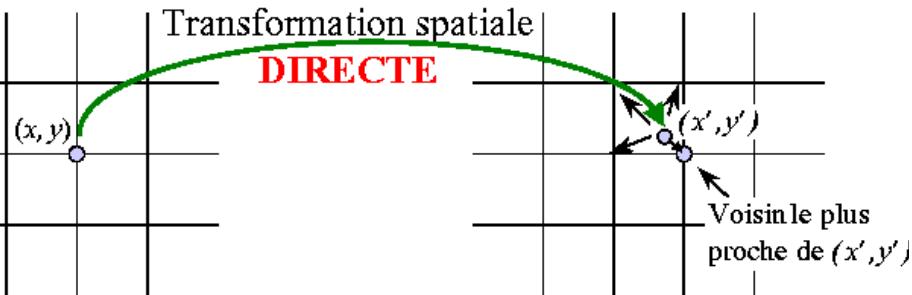

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE INTERPOLATION DIRECTE (2)

Transformée spatiale inverse

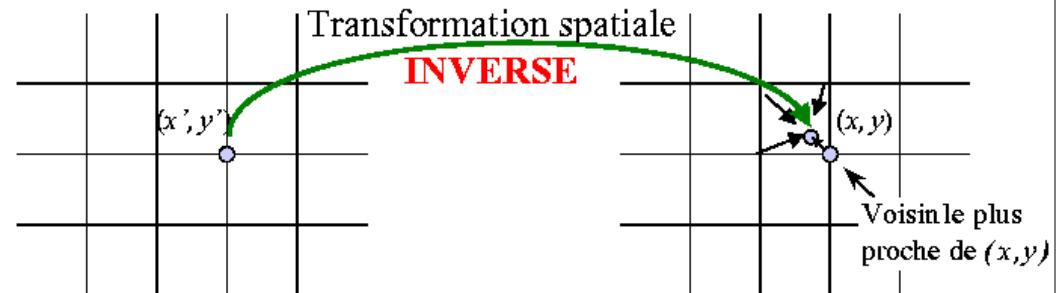

- Difficile de distribuer le niveau de gris sur les pixels voisins
- Des "trous" peuvent apparaître car on n'a pas la certitude que tous les pixels de l'image transformée recevront une valeur

Exemple

Transformation : Facteur d'échelle 10×

$A(x_0, y_0)$ ► $A(x_0, y_0)$ et $B(x_0 + 1, y_0)$ ► $B(x_0 + 10, y_0)$


Mais entre $A(x_0, y_0)$ et $B(x_0 + 10, y_0)$?

Exemple



512 × 512 ► 64 × 64

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE INTERPOLATION BILINÉAIRE (1)

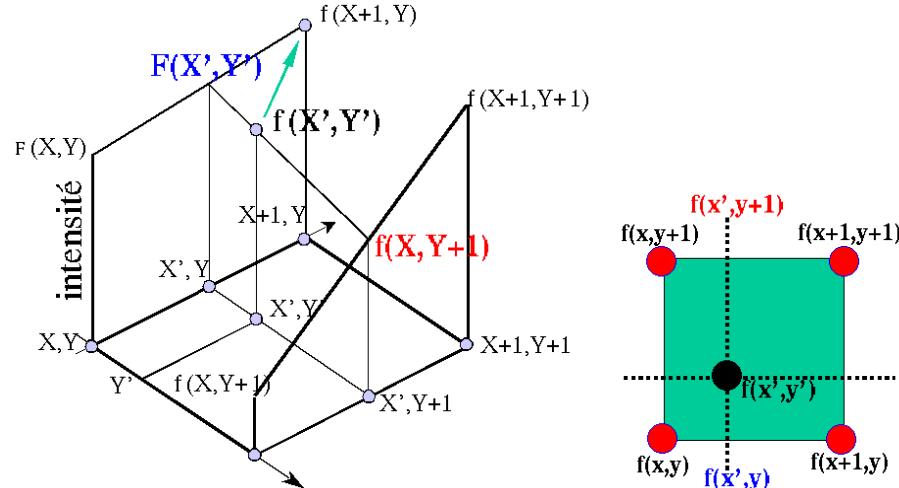

$$f(x, y) = ax + by + cxy + d$$

4 inconnus \blacktriangleright 4 points

Résolution du système

$$a = f(x+1,y) - f(x,y)$$

$$b = f(x,y+1) - f(x,y)$$

$$c = f(x+1,y+1) + f(x,y) - f(x,y+1) - f(x+1,y)$$

$$d = f(x,y)$$

(4 Multiplications et 8 additions)

Implantation

$$f(x',y) = f(x,y) + (x' - x)[f(x+1,y) - f(x,y)]$$


$$f(x',y+1) = f(x,y+1) + (x' - x)[f(x+1,y+1) - f(x,y+1)]$$

$$f(x',y') = f(x',y) + (y' - y)[f(x',y+1) - f(x',y)]$$

(3 Multiplications et 6 additions)

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE INTERPOLATION BILINÉAIRE (2)

Exemple

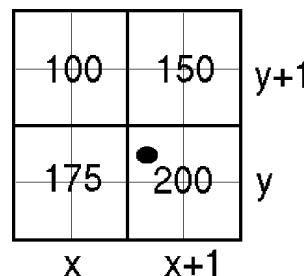

Quel est la valeur interpolée en $(x+0.7, y+0.2)$?

- Interpolation au voisin le plus près : 200
- Interpolation bilinéaire

$$\begin{aligned} I(x',y) &= I(x,y) + [I(x+1,y) - I(x,y)](x' - x) \\ &= 175 + (200 - 175) \times 0.7 = 192.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(x',y+1) &= I(x,y+1) + [I(x+1,y+1) - I(x,y+1)](x' - x) \\ &= 100 + (150 - 100) \times 0.7 = 135 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(x',y') &= I(x',y) + [I(x',y+1) - I(x',y)](y' - y) \\ &= 192.5 + (135 - 192.5) \times 0.2 = 181 \end{aligned}$$


Exemple



512 × 512 \blacktriangleright 64 × 64

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE AUTRES INTERPOLATION


Interpolation linéaire



$$f(x, y) = ax + by + c$$


B-splines cubique

B-Spline cubique

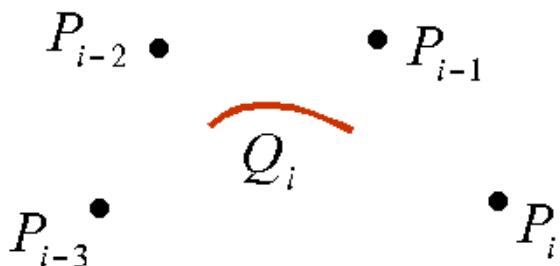


$$Q_i(t) = [t^3 \quad t^2 \quad t \quad 1] \cdot \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{i-3} \\ P_{i-2} \\ P_{i-1} \\ P_i \end{bmatrix}$$

TOMOGRAPHIE RECONSTRUCTION À PARTIR DE PROJECTIONS

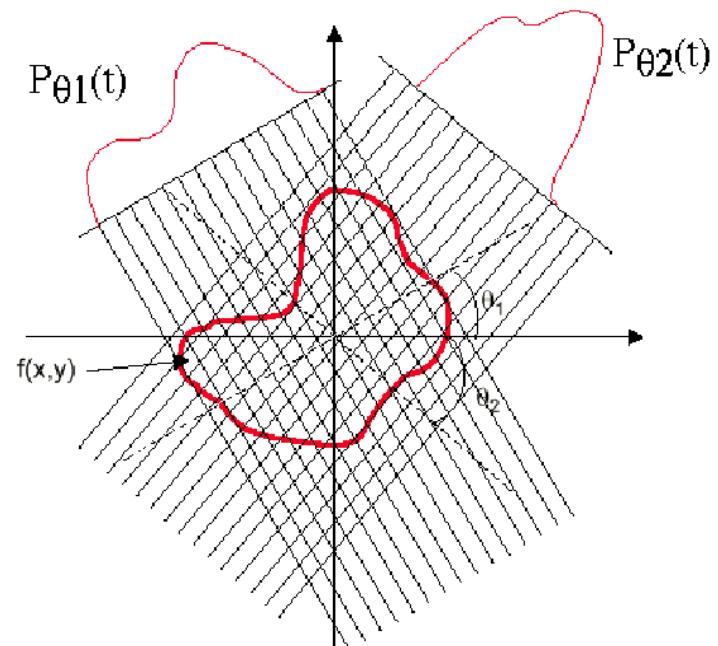

TOMOGRAPHIE

THÉO. DE LA TRANCHE CENTRALE DE FOURIER (1)

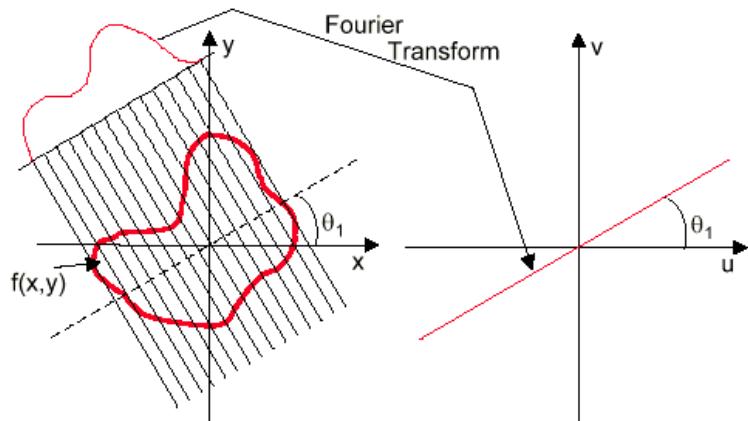

Considérons la Transformée de Fourier de $f(x, y)$

$$F(u, \nu) = \iint f(x, y) \exp(-2\pi j(ux + \nu y)) dx dy$$

Que représente la ligne $\nu = 0$ du spectre de Fourier ?

$$F(u, 0) = \int \left[\int f(x, y) dy \right] \exp(-2\pi j(ux)) dx$$


$$F(u, 0) = \mathcal{F}(p_{\theta=0^\circ}(t)) \text{ de même } F(0, \nu) = \mathcal{F}(p_{\theta=90^\circ}(t))$$

Plus généralement, pour une projection de l'image suivant un angle θ (i.e., suivant un axe de projection passant par l'origine et orienté selon un angle θ)

$$p_{\theta}(t) = \int_l f(x, y) dl$$

TOMOGRAPHIE

THÉO. DE LA TRANCHE CENTRALE DE FOURIER (2)

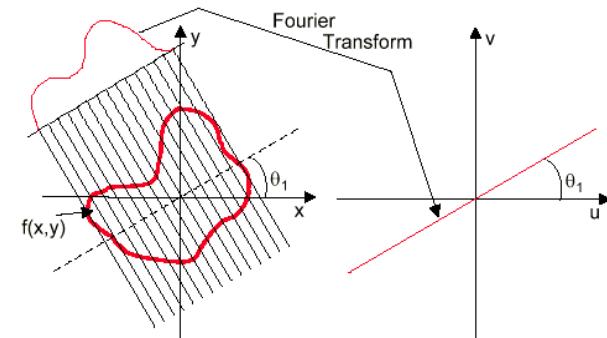

Une ligne de projection au point t est (cf. Hough)

$$x \cos \theta + y \sin \theta = t$$

On obtient donc

$$p_{\theta}(t) = \iint f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - t) dx dy$$

La TF de $p_{\theta}(t)$ est

$$P_{\theta}(w) = \int p_{\theta}(t) \exp(-2\pi j w t) dt$$

$$P_{\theta}(w) = \int \left[\iint f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - t) dx dy \right] \exp(-2\pi j w t) dt$$

En utilisant la propriété du δ , ($f(x)\delta(x-a)=f(a)\delta(x-a)$)

$$P_{\theta}(w) = \iint f(x, y) \exp(-2\pi j w [x \cos \theta + y \sin \theta]) dx dy$$

Sachant que la TF 2D est


$$F(u, \nu) = \iint f(x, y) \exp(-2\pi j(ux + \nu y)) dx dy$$

TOMOGRAPHIE

THÉO. DE LA TRANCHE CENTRALE DE FOURIER (3)

Si on pose $u = w \cos \theta$ et $v = w \sin \theta$, on a l'équation de l'axe de projection dans le domaine de Fourier

Donc à une ligne du spectre de Fourier d'orientation θ correspond la TF de la projection de l'image selon cet angle

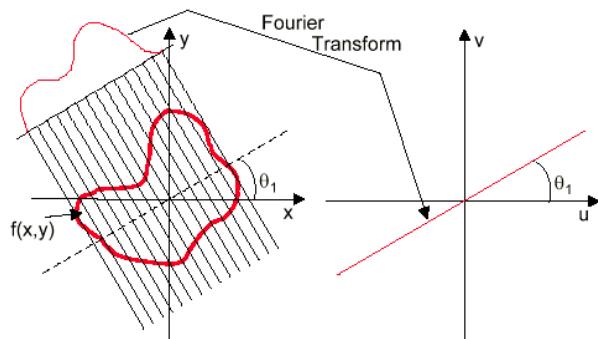

Si on empile les différentes projections $p_\theta(t)$ d'une image dans une matrice $g(\theta, t)$, on obtient la Transformée de Radon

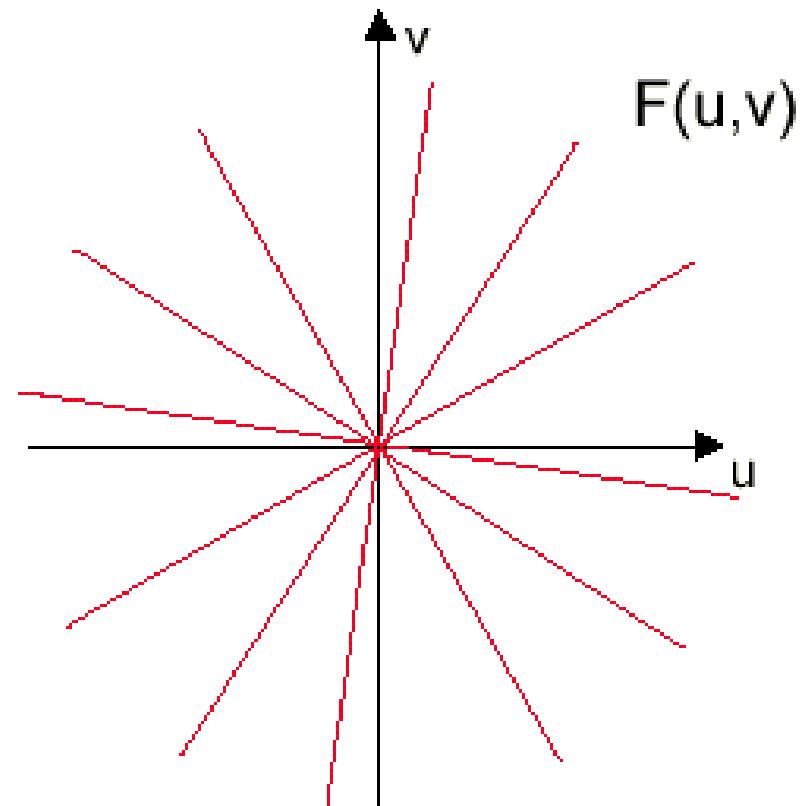


Image lenna



TF Radon


TOMOGRAPHIE RECONSTRUCTION




Reconstruction

- Interpolation des points manquant de $F(u,v)$, par exemple ► interpolation bilinéaire
- Transformée de Fourier inverse de $F(u,v)$ pour obtenir $f(x,y)$ ► Cf. TP

TOMOGRAPHIE EXEMPLES

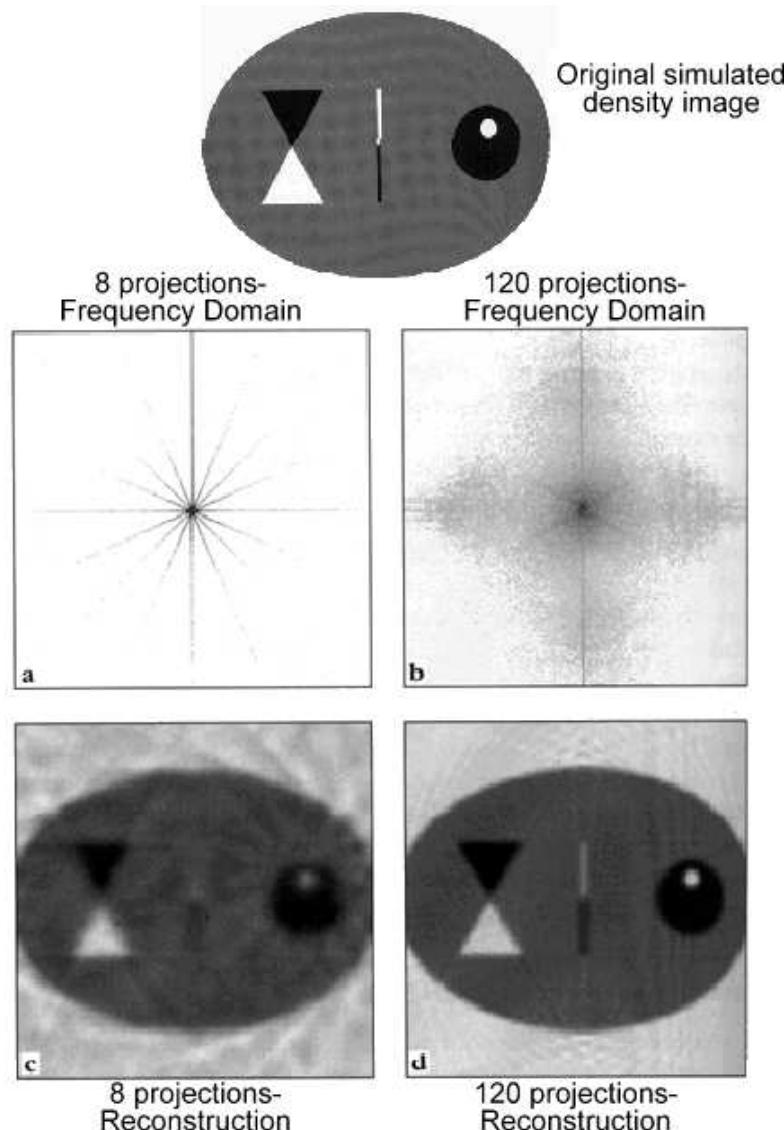

TOMOGRAPHIE RÉTROPROJECTION (1)

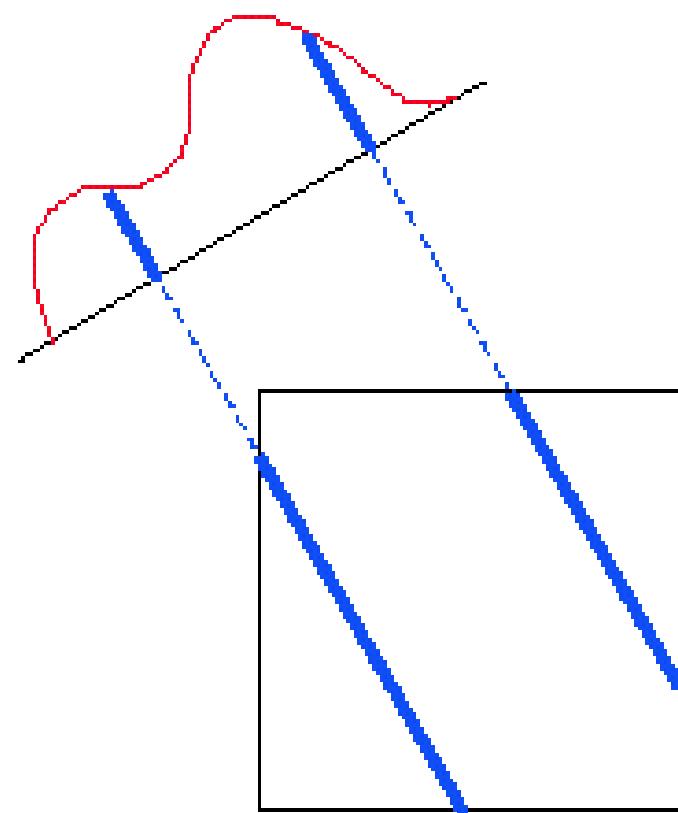


Principe de la rétroprojection

- $p_\theta(t)$ est rétroprojecté le long des lignes de projections
- Les valeurs de $p_\theta(t)$ sont ajoutées aux valeurs existantes obtenues des autres projections


TOMOGRAPHIE RÉTROPROJECTION (2- EXEMPLE)

1 view

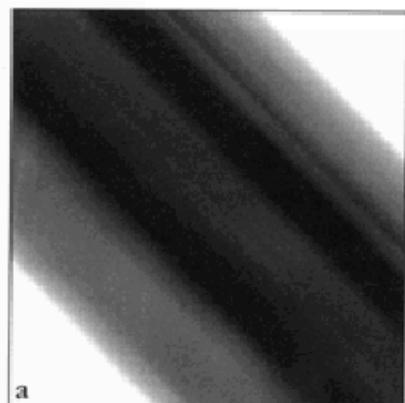

3

8 views

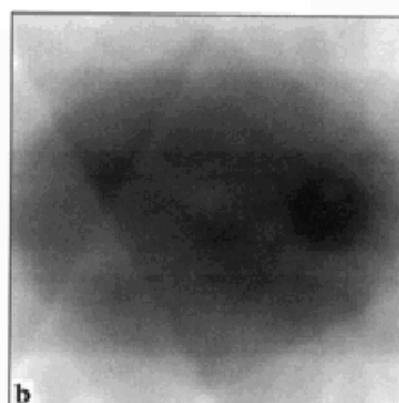

1

This micrograph shows a dark, irregular, and somewhat granular structure, possibly a cell or a tissue sample, against a lighter background. The label 'c' is located in the bottom left corner of the image frame.

32 views

► Reconstruction flow

Un point rétroprojecté ne donnera pas un point mais une "tache"

Solution : Infinité de Projections

TOMOGRAPHIE RÉTROPROJECTION FILTRÉE (3)

La TF inverse de $F(u, \nu)$ est

$$f(x, y) = \iint F(u, \nu) \exp(2\pi j(ux + \nu y)) du d\nu$$

En coordonnées polaires

$$f(x, y) = \iint F(w, \theta) \exp(2\pi j(xw \cos \theta + yw \sin \theta)) |w| dw d\theta$$

Puisqu'on obtient $F(w, \theta)$ à partir des projections $P_\theta(w)$

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= \iint \left[P_\theta(w) |w| \right] \exp(2\pi j w(x \cos \theta + y \sin \theta)) dw d\theta \\
 &= \iint \left[\int P_\theta(w) |w| \exp(2\pi j w t) dw \right] \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - t) dt d\theta \\
 &= \underbrace{\iint p_\theta(t)_{\text{filtrée}} \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - t) dt d\theta}_{\text{Rétroprojection de } p_\theta(t)}
 \end{aligned}$$

(le long d'une ligne de projection d'orientation θ
et passant par l'origine)


Principe de la rétroprojection filtrée

- On calcule $P_\theta(w)|w|$ (projection filtrée)
- On fait la TF inverse de $P_\theta(w)$ filtrée
- On rétroprojecté pour tous les angle θ

TOMOGRAPHIE RÉTROPROJECTION FILTRÉE (4)

Réduction du bruit

- L'objet à reconstruire est bande-limité
- On a donc généralement intérêt à multiplier dans le domaine fréquence par une fenêtre de Hamming (filtre passe-bas)
- $|u|$ n'est pas carré intégrable (Fourier inverse impossible)

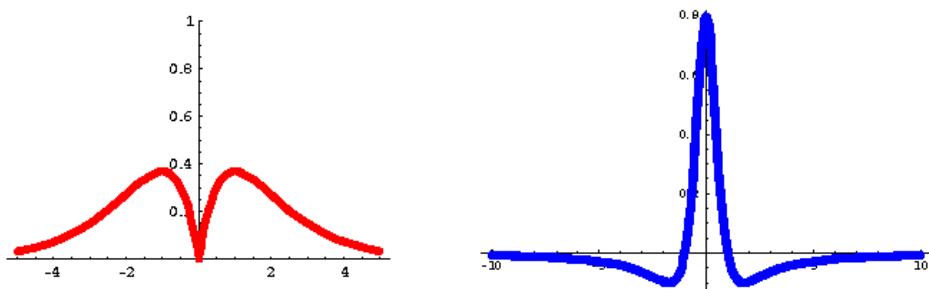

TOMOGRAPHIE RÉTROPROJECTION FILTRÉE (5)

Exemple

